

天星冷链管理系统

V1.0

Effid Cold Chain Management System

冰箱>历史数据查询>温湿度数据折线图

时间区间:

2026-02-01 00:00:00 ~

2026-02-28 23:59:59

查询

返回

GCP药房1号冰箱

区间内最高温: 6.30°C


区间内最低温: 4.79°C

探头编号: 0421

仓库: 宣武医院 冰箱: GCP药房冰箱1

温度折线图

宣武医院 GCP药房冰箱1

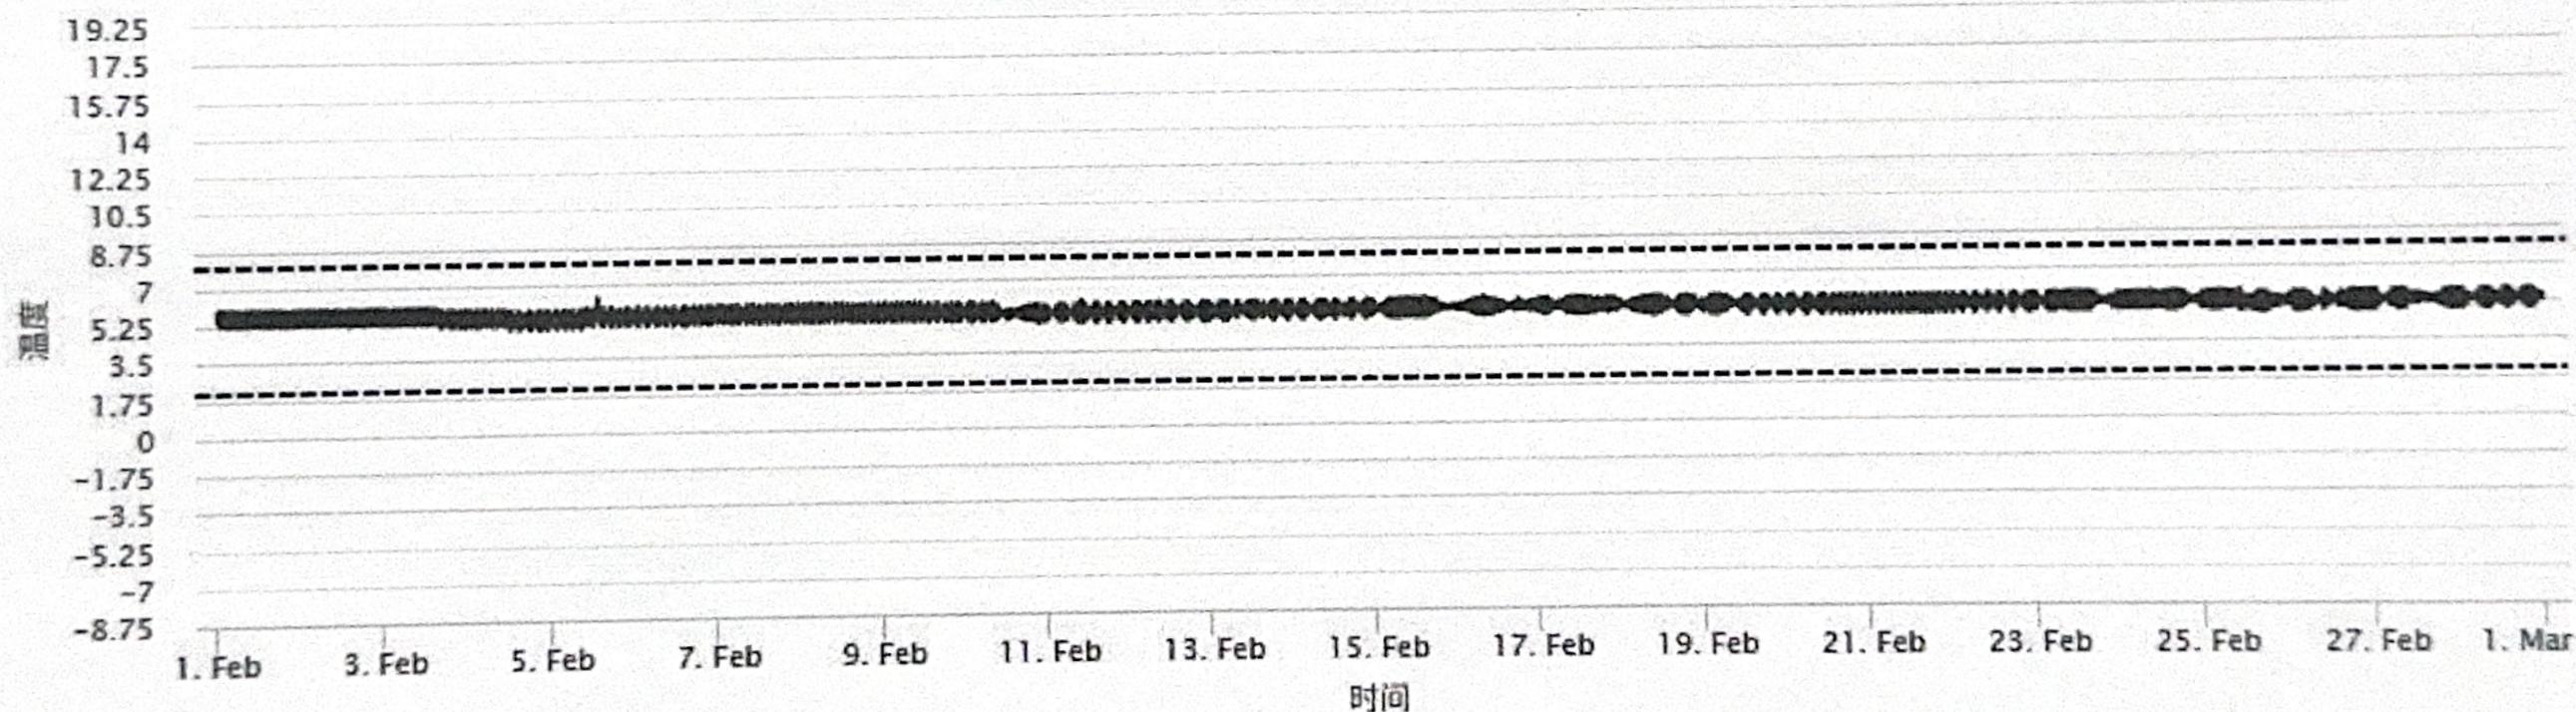

← 0421

←
2026.3.2

Highcharts.com