

天星冷链管理系统

V1.0

Rfid Cold Chain Management System

冰箱>历史数据查询>温湿度数据折线图

时间区间:

2026-02-01 00:00:00

2026-02-28 23:59:59

查询

返回

GCP药房2号冰箱

区间内最高温: 5.81°C


区间内最低温: 3.92°C

探头编号: 0416

仓库: 宣武医院 冰箱: GCP药房冰箱2

温度折线图

宣武医院 GCP药房冰箱2

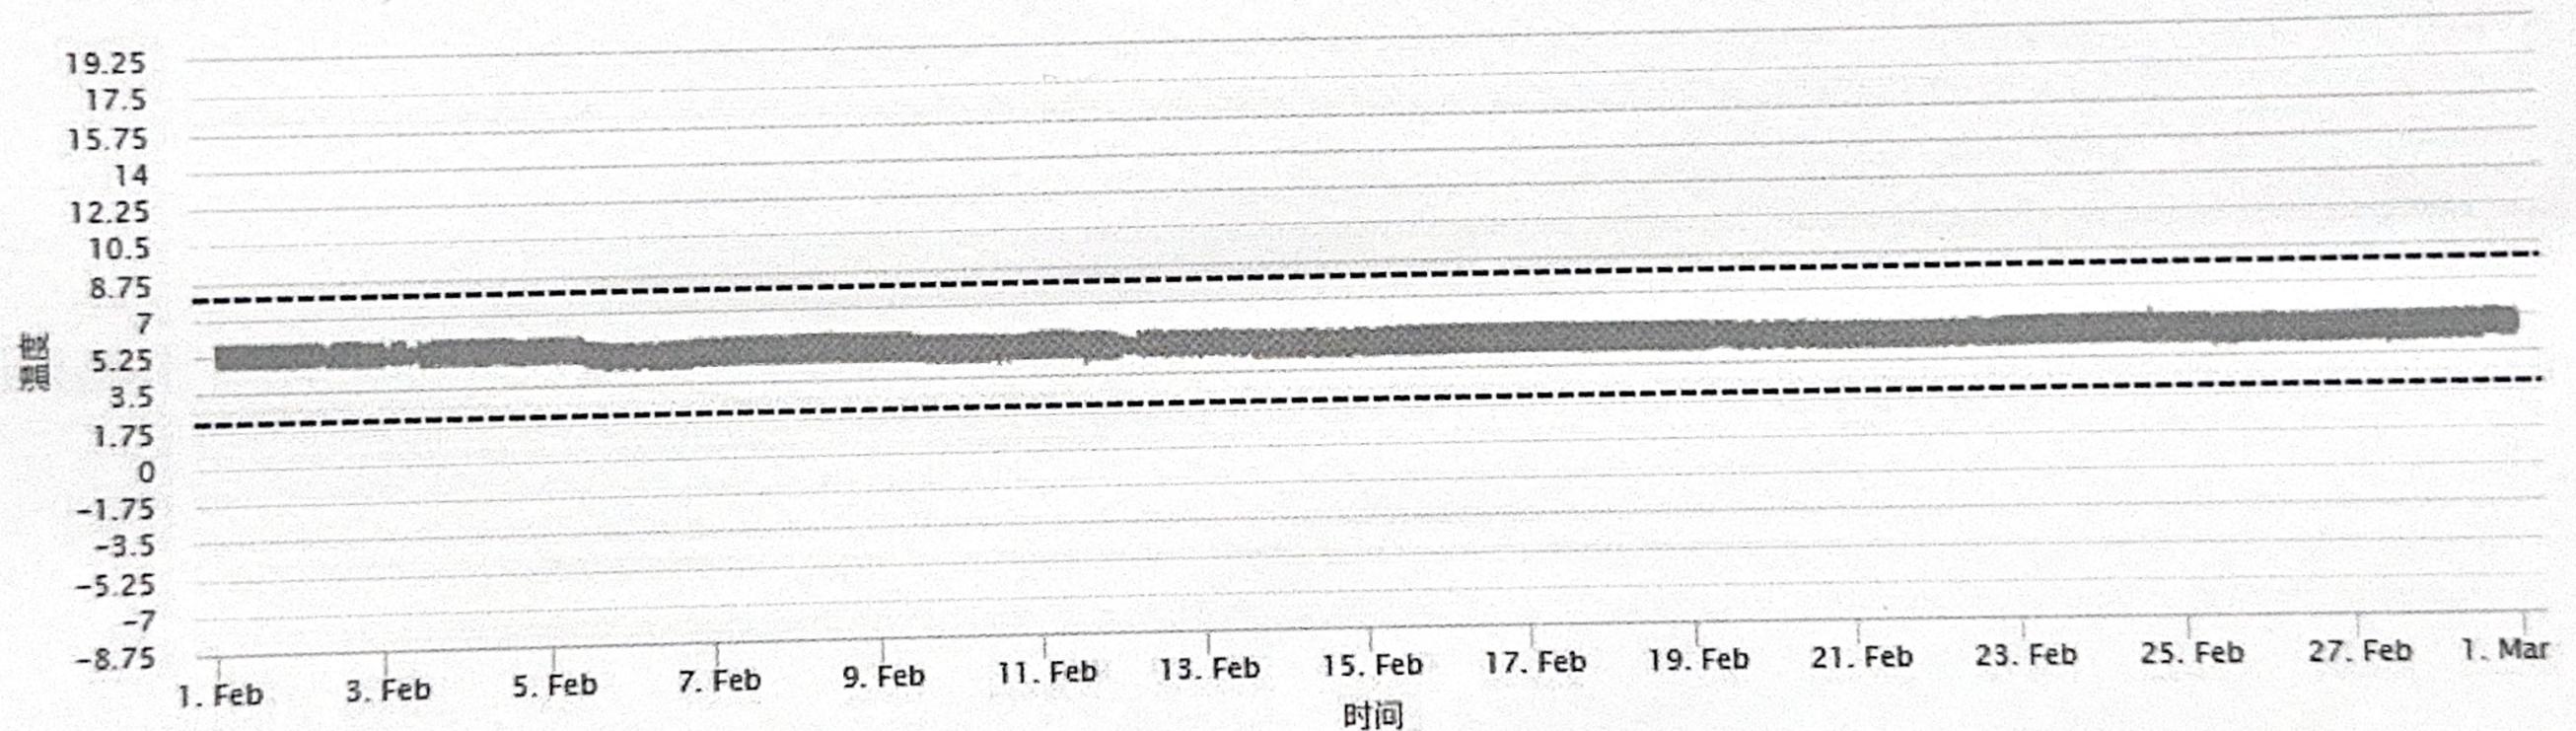

0416

Handwritten signature and date: 2026.3.2

Highcharts.com