

天星冷链管理系统

V1.0

Cold Chain Management System

冰箱>历史数据查询>温湿度数据折线图

时间区间: 2026-03-01 00:00:00 ~ 2026-03-31 23:59:59

查询 返回

GCP药房1号冰箱

区间内最高温: 6.09°C


区间内最低温: 4.49°C

探头编号: 0421

仓库: 宣武医院 冰箱: GCP药房冰箱1

温度折线图

宣武医院 GCP药房冰箱1

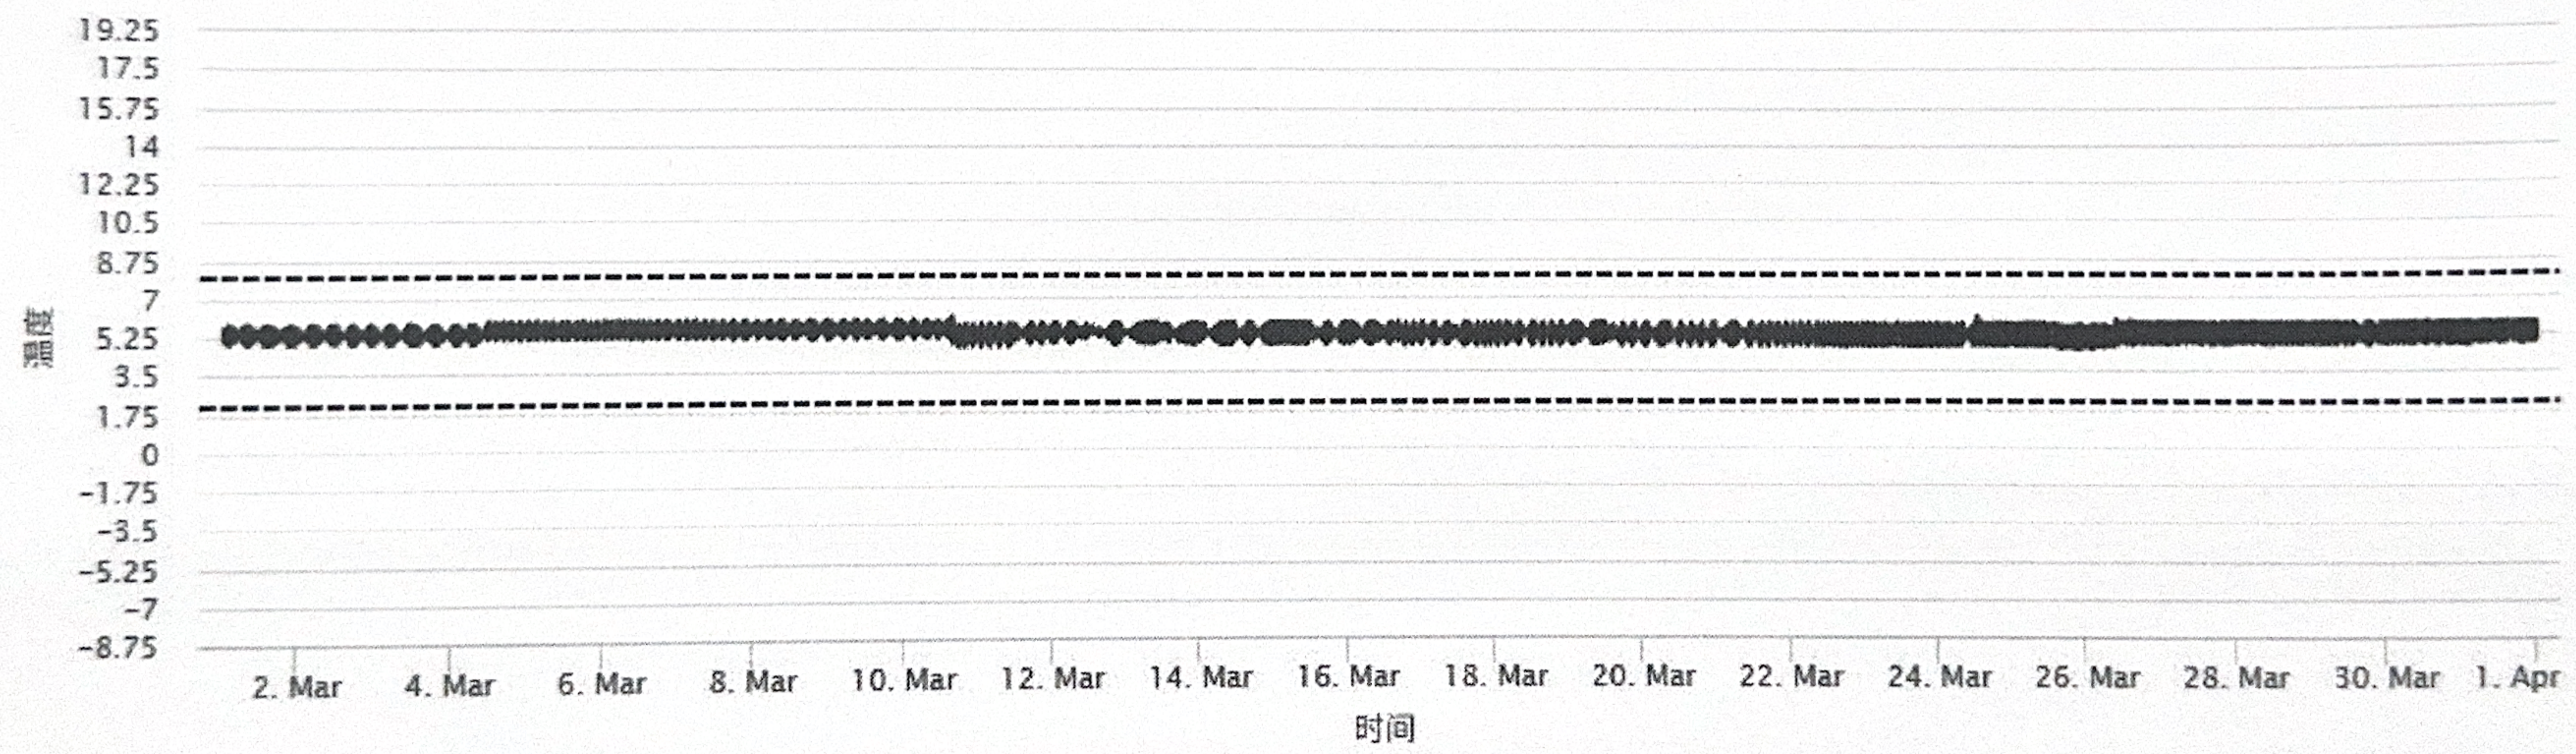

← 0421

Handwritten signature and date: 26.4.1