

天星冷链管理系统

V1.0

RFID Cold Chain Management System

冰箱>历史数据查询>温湿度数据折线图

时间区间:

2026-05-01 00:00:00 ~

2026-05-31 23:59:59

查询

返回

GCP药房2号冰箱

区间内最高温: 6.12°C


区间内最低温: 4.01°C

探头编号: 0416

仓库: 宣武医院 冰箱: GCP药房冰箱2

温度折线图

宣武医院 GCP药房冰箱2

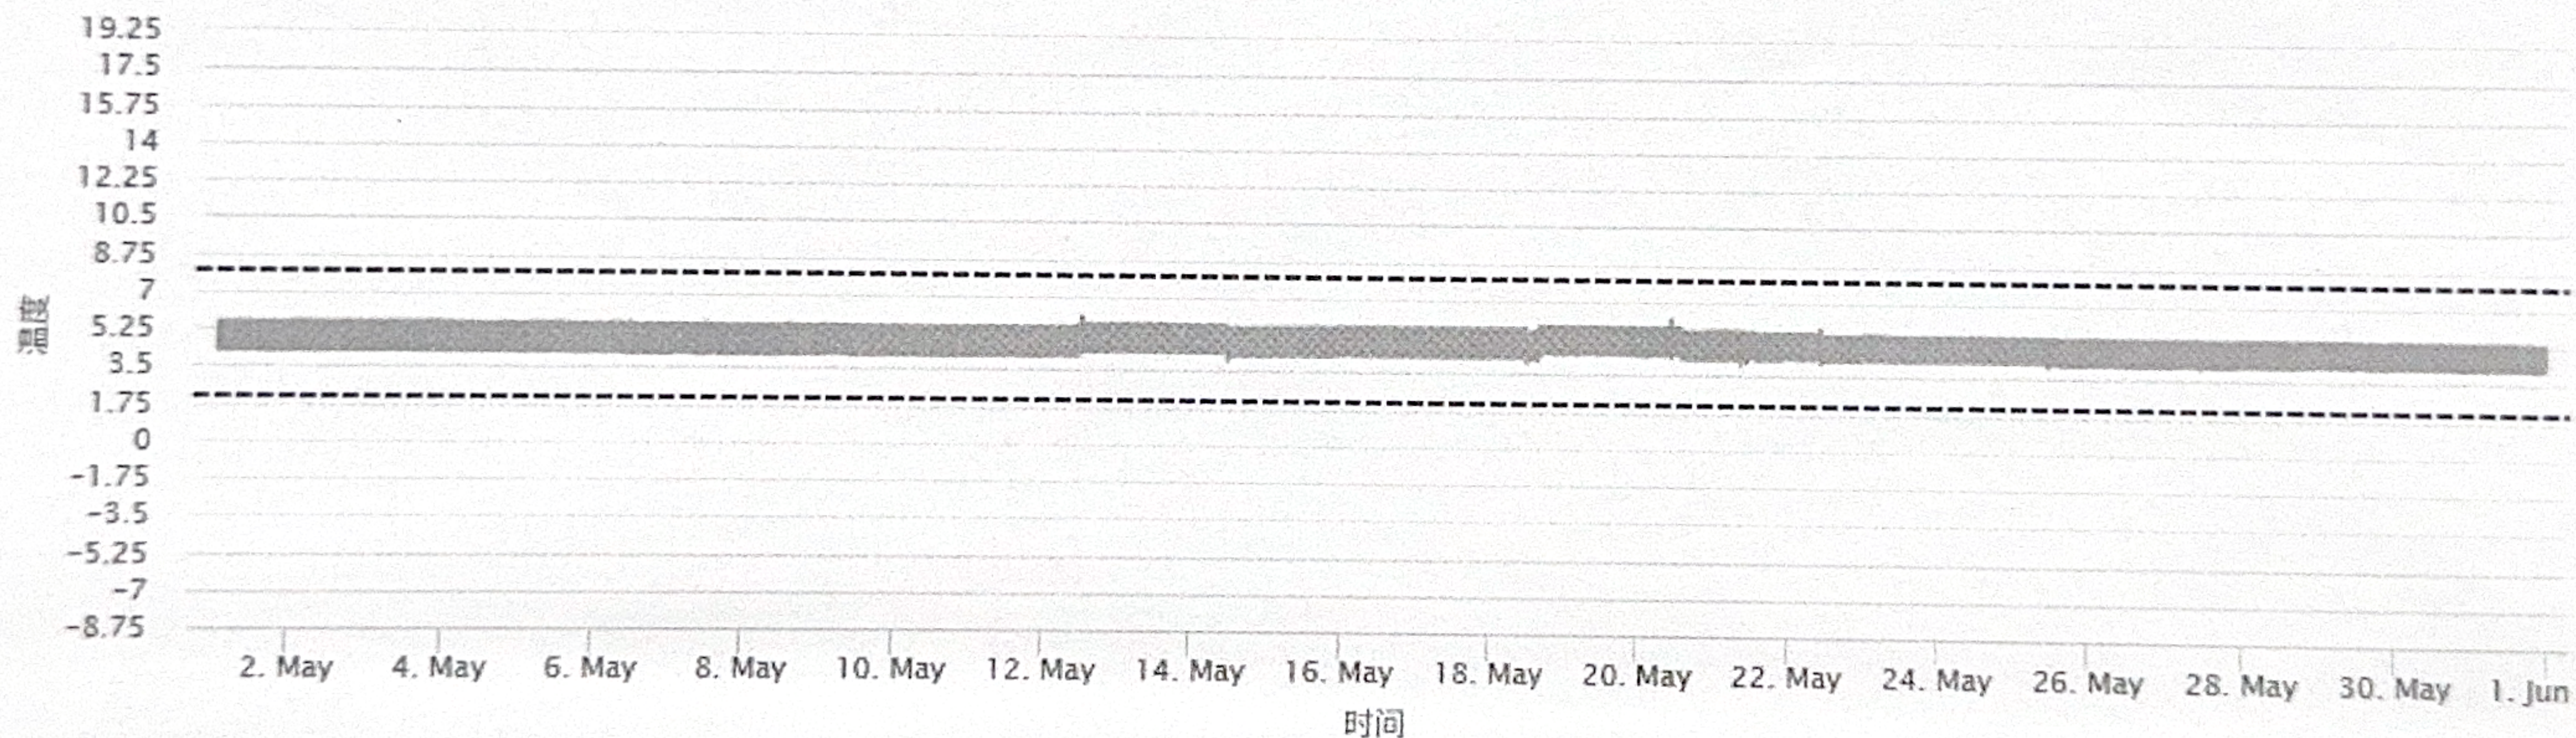

0416

2026.6.1

Highcharts.com